

深圳市计量质量检测研究院

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 1 页 共 8 页

项 目 名 称 : 南山区西丽人民医院全自动封闭脱水机

项 目 编 号 : NSCG2015032148

合 同 编 号 : ——

采 购 单 位 : 深圳市南山区西丽人民医院

供 应 商 : 武汉中纪科学仪器有限公司

抽检委托机构: 深圳市南山区政府采购及招标中心

抽检检验机构: 深圳市计量质量检测研究院

(检验专用章)



签发日期: 2015年06月05日

签发人:

审 核:

主 检:

Handwritten signatures for the Issuer, Reviewer, and Main Inspector.

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 2 页 共 8 页

一、总表名称

项目名称	南山区西丽人民医院全自动封闭脱水机		
采购单位	深圳市南山区西丽人民医院		
中标供应商	武汉中纪科学仪器有限公司		
委托单位	深圳市南山区政府采购及招标中心		
项目编号	NSCG2015032148	现场抽检日期	2015 年 06 月 03 日
现场抽检地点	西丽人民医院病理科	环境条件	(22~24)℃, (56~58)%RH
现场抽检依据	政府采购项目抽检方案、采购合同及项目招投标文件		
抽检结果及建议	在抽检现场,甲方提供了项目验收报告,该项目经过甲方的验收。 通过对深圳市南山区西丽人民医院全自动封闭脱水机项目现场抽样检查,发现以下几方面与项目招投标文件的要求不符合。 一. 技术要求 1. 可自定义 15 个脱水程序,可设置 5 个常用程序到桌面,与招投标文件规定不符。 2. 试剂温度可设定范围为 (35~55)℃,与招投标文件规定的相符。 3. 未能显示试剂的清洁度,与招投标文件规定不符。 检验机构代表签字:  2015 年 06 月 03 日		

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 3 页 共 8 页

二、商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	4.1 交货及完成安装的期限	应符合采购合同中规定的要求,即“交货期的要求:签订合同后 30 天(日历日)内。”。	符合 合同签订时间: 2015 年 03 月 06 日 验收时间: 2015 年 04 月 01 日	符合
2	4.2 数量、规格型号	应符合“南山区西丽人民医院全自动封闭脱水机项目招投标资料”所规定的要求。	符合	符合
3	4.3 质量合格凭证或文件	供应商应提供产品的质量合格凭证或文件。	符合	符合
4	4.4 产品保修及其他服务文件	供应商应提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料,并提供由产品生产厂家签署承诺的合法、有效的保修、维修证明,该证明应符合合同规定的要求。	符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 4 页 共 8 页

三、技术要求

序号	检查项目	项目要求	样品数量	单位	实测结果	单项判定
1	主要技术规格	1、纯中文软件,任何界面下全部中文显示;配备防腐蚀的彩色触摸屏,图像化实时监测。	—	—	符合	符合
		2、WINDOWS 操作系统,有文档处理功能,可备份用户脱水程序及机器运行日志。			符合	符合
		3、可自定义 ≥ 15 个脱水程序,可以设置 ≥ 5 个常用程序到桌面,可以使用“智能启动”方式,快速启动脱水程序。			最多可自定义15个脱水程序,设置5个常用程序到桌面,可以使用“智能启动”方式,快速启动脱水程序。	不符合
		4、配备智能化系统,保证断电或者试剂瓶缺失的情况下任然防止样品的损坏。			符合	符合
		5、配备完全封闭的气雾系统,保证无害的工作环境。			具有封闭的工作环境	—
		6、具有试剂相容性检测功能,按照相容性分组,有效避免程序设置错误。			符合	符合
		7、具有预检测功能,测试阀门和泵是否处于正常状态。			现场无法确认	—
		8、实现实时应用和维护支持的远程维护系统,远程对机器的运行状况进行监控,可远程提供维修和应用支持。			符合	符合
		9、试剂/石蜡灌注和排放可通过外接方式自动完成,减少人工操作量。			符合	符合
		10、配备试剂管理系统,智能管理酒精、透明剂及石蜡,根据各瓶试剂的清洁度智能的安排使用顺序,有效的节省试剂。			未能显示各瓶试剂的清洁度	不符合
		11、具有主动石蜡清洁程序,能有效降低石蜡中可溶性杂质,延长石蜡使用寿命,提高脱水质量。			具有主动石蜡清洁程序	—
		12、可设置 ≥ 4 种用户自定义的清洗程序。			可设置4种用户自定义的清洗程序	—
		13、具有2级密码保护功能。			符合	符合
		14、配备 ≥ 2 个光学传感器感知最低和最高液平面,实时监测试剂液位,保证脱水效果。			配备2个光学传感器	—
		15、最大处理量 ≥ 200 个标准包埋盒。			符合	符合
		16、配备不锈钢材料的脱水缸。			配备金属脱水缸	—
		17、倒锥体脱水缸盖设计,减少试剂的交叉感染。			有倒锥体脱水缸盖	—
		18、试剂缸容量 ≤ 3.3 升,脱水缸容积为 ≤ 3.3 升,保证脱水效果,有效节省试剂。			现场无法确认	—
		19、脱水缸温度具备调节功能,石蜡温度范围:40℃~65℃,试剂温度范围:室温,30℃~55℃。			石蜡温度设定范围:40℃~65℃ 试剂温度设定范围:35℃~55℃。	不符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 5 页 共 8 页

序号	检查项目	项目要求	样品数量	单位	实测结果	单项判定
		20、具备磁力棒搅拌功能,重复循环式搅拌(泵入/泵出)功能。			具备搅拌功能	——
		21、排液 3 步, 80、120、140 秒。			符合	符合
		22、具有抽真空和加压功能: 真空 $\leq -70\text{kPa}$; 压力 $\geq +35\text{kPa}$ 。			具有抽真空和加压功能	——
		23、孵育时间: 0—99 小时 59 分钟。			能设定孵育时间: 0~99 小时 59 分钟	符合
		24、具有延时启动功能,最长可为 7 天,更灵活的工作流程。			符合	符合
		25、配备 3 个蜡缸, 10 个脱水试剂瓶,至少 3 个独立的清洗试剂瓶。			符合	符合
2	配置清单	主机	1	台	符合	符合
		样本篮	2	个	符合	符合
		试剂瓶	13	个	符合	符合
		废液收集器	1	个	符合	符合
		活性炭过滤网	2	个	符合	符合
		操作手册	1	份	符合	符合
		电缆	1	根	符合	符合
		维护工具包	1	个	符合	符合
		酒精浓度测试仪	1	台	符合	符合

四、抽检现场照片



附图 1




附图 2


政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 7 页 共 8 页

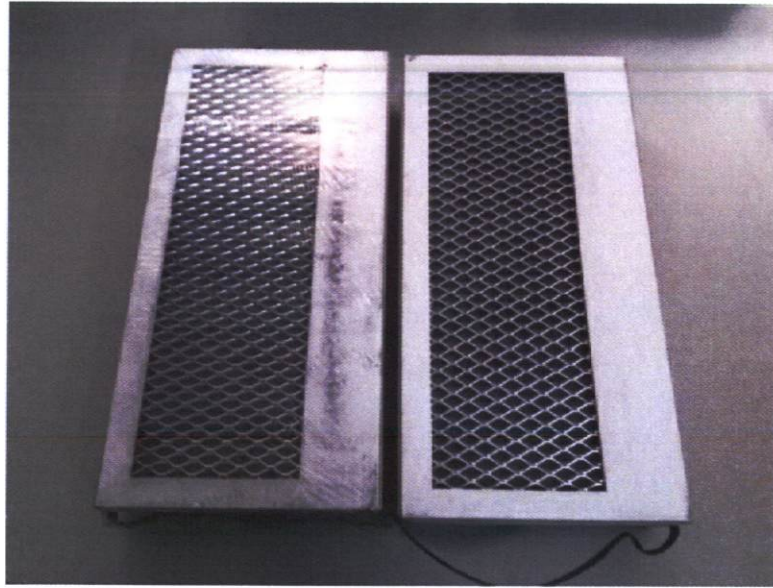

附图 3

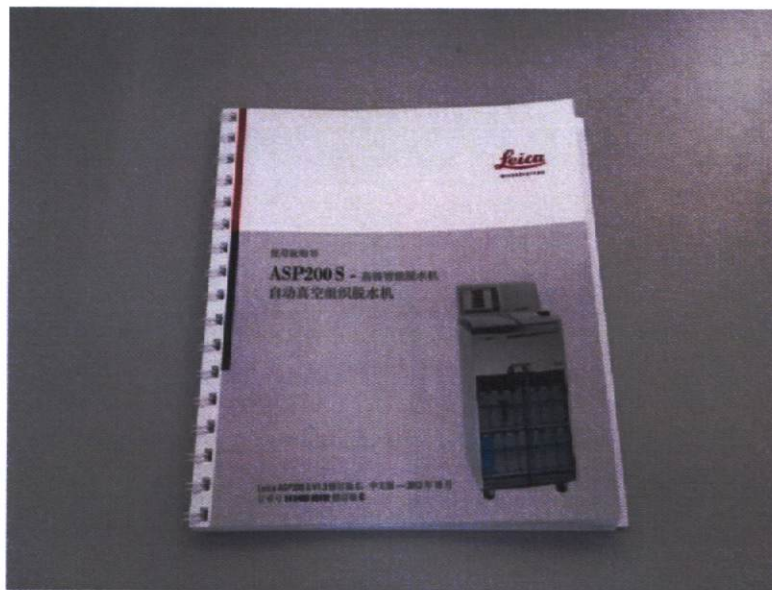

附图 4

政府采购项目抽检报告

报告编号: 155003045

第 8 页 共 8 页



附图 5



附图 6

以下空白